MENISCUS VERSAFLEX

SUTURA DO MENISCO ALL INSIDE

PORTUGUÊS

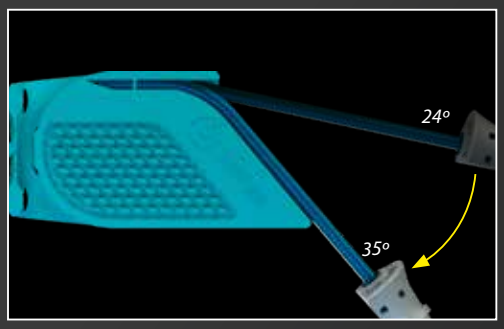

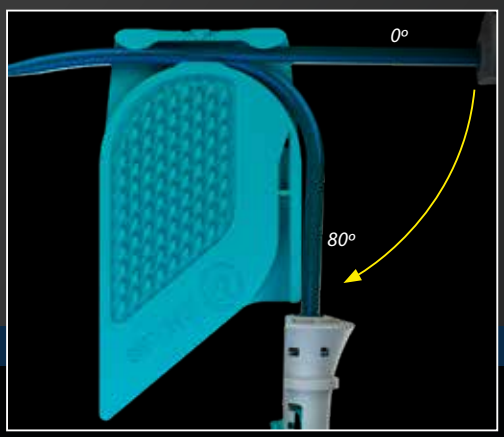

GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2023

VERSAFLEX

O dispositivo é composto por botões em PEEK e fio #2-0 knotless, que proporciona tratamento "*all-inside*" das lesões do menisco, guiados por agulha com haste flexível que permite acessar todas as zonas do menisco utilizando o portal anterior padrão.

O mecanismo de aplicação do VersaFlex permite implantação utilizando apenas uma mão.

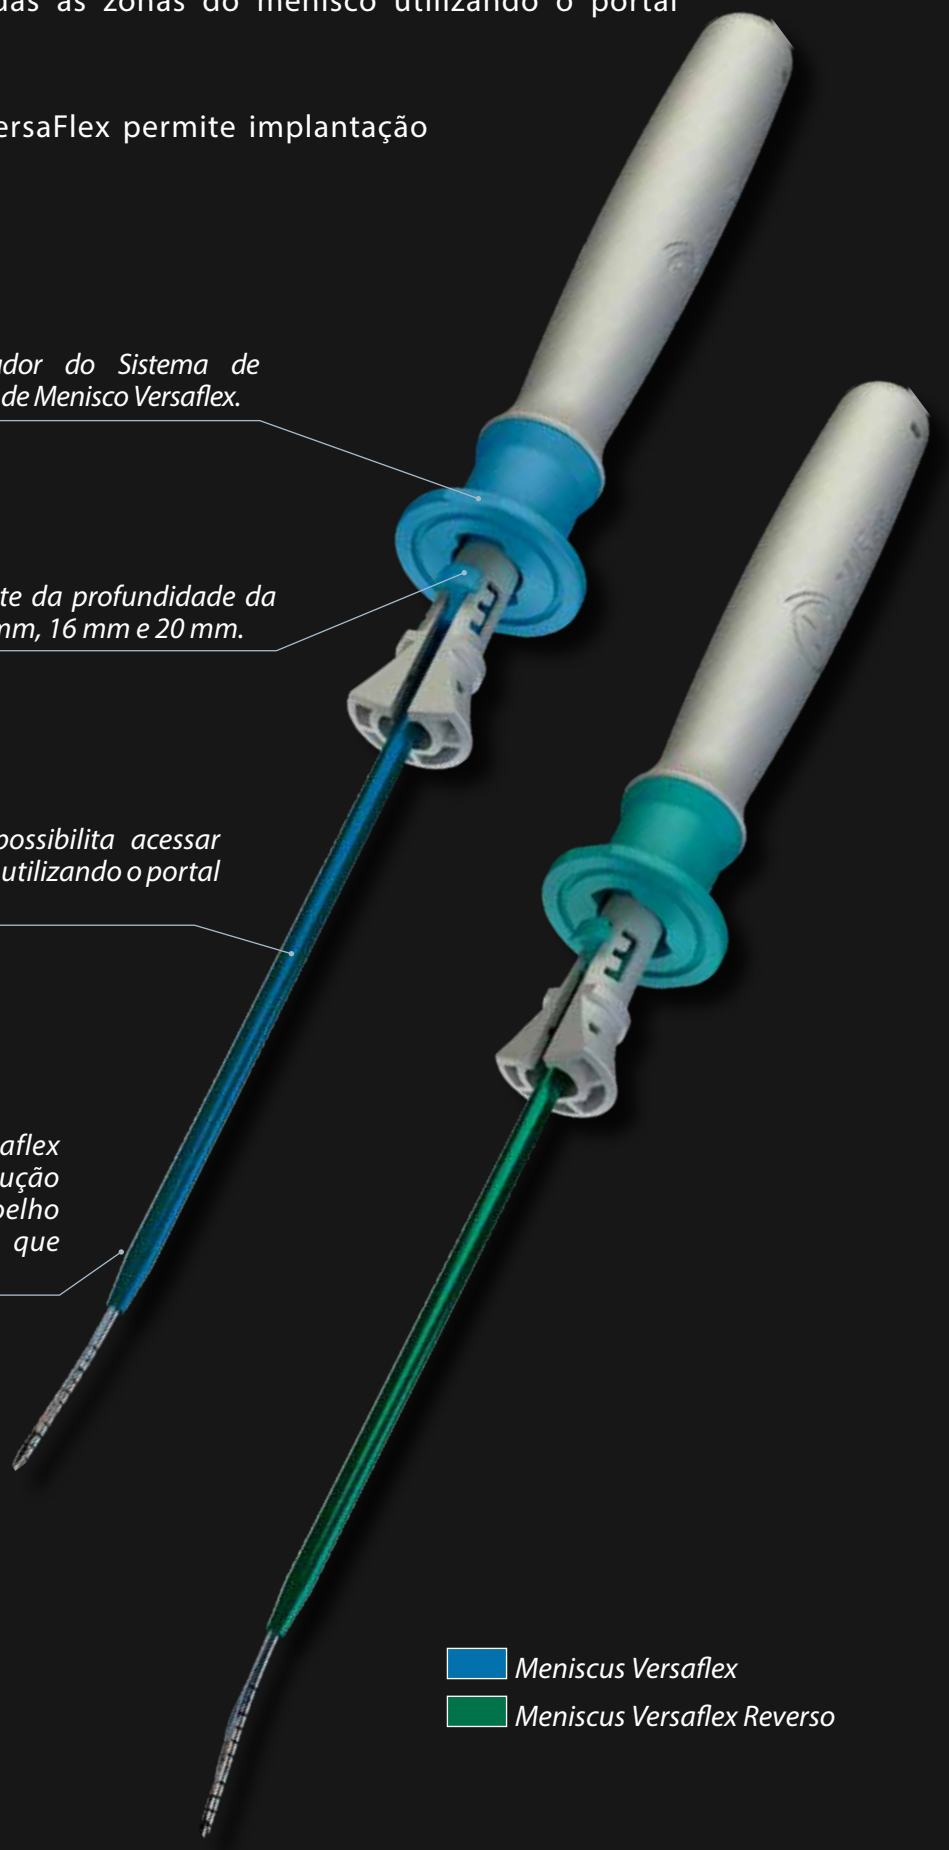

Agulha com Ø1.6 mm e implantes montados afileiradaos proporciona menor acesso para introdução do Versaflex na articulação.

Fio trançado colorido facilita a visualização após implantação no menisco.

Ponta com graduação a laser permite rápida referência da profundidade de penetração da agulha.

Modelador

Todas as zonas do menisco

Técnica All-inside

TÉCNICA CIRÚRGICA

1. Definir qual dispositivo Versaflex é mais adequado ao procedimento considerando: a zona de lesão, o acesso e a modelagem que será feita na haste do dispositivo.

2. Modelagem: Realizar a modelagem da ponta e/ou da haste do Versaflex conforme o planejamento cirúrgico.

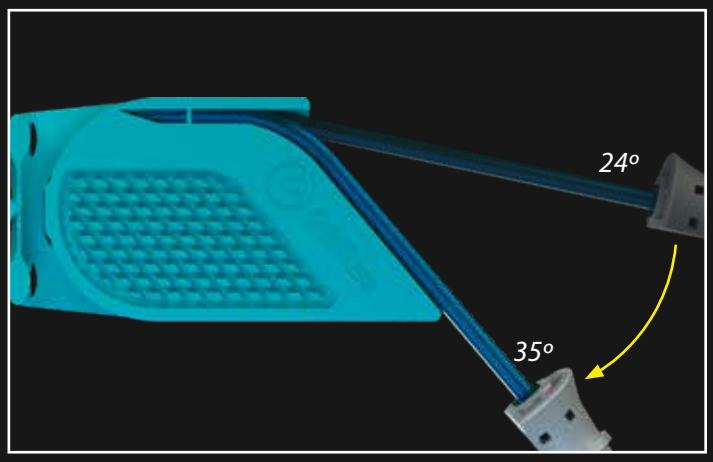

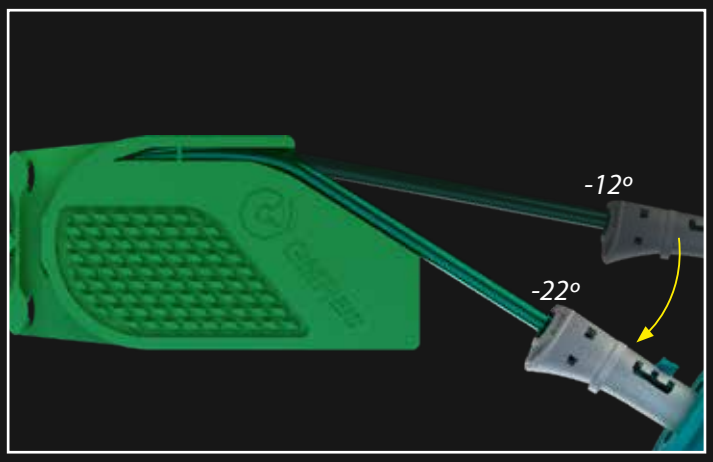

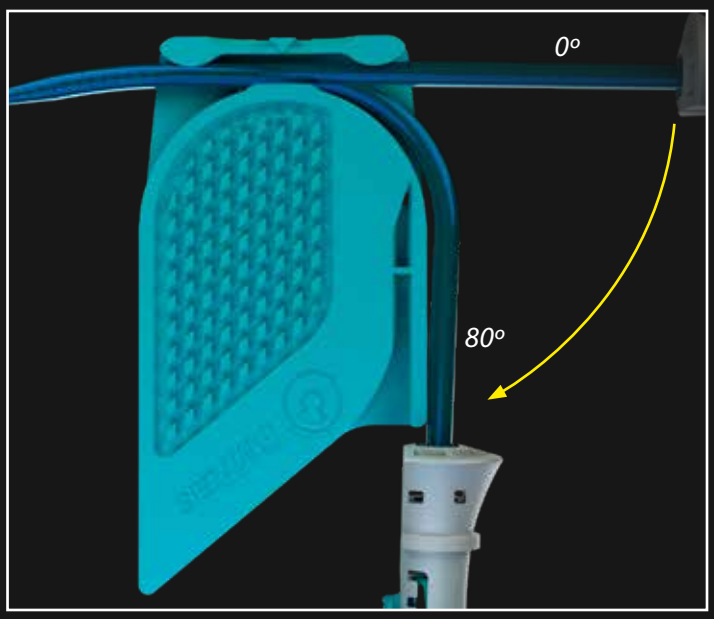

Figs.: A ponta do Meniscus Versaflex permite modelagem dos originais 24° até 35°, e a haste permite modelagem de 0° a 80°.

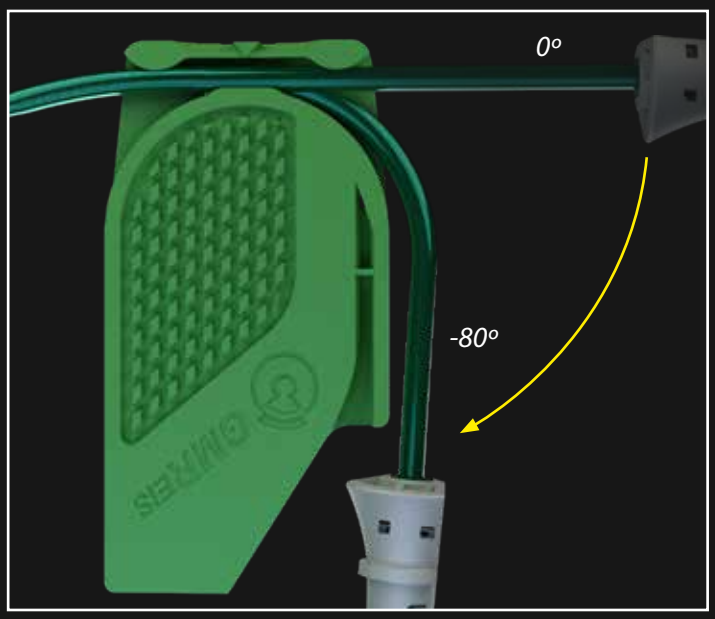

Figs.: A ponta do Meniscus Versaflex Reverso permite modelagem dos originais -12° até -22°, e a haste permite modelagem de 0° a -80°.

Demonstração da utilização do Meniscus Versaflex para as diferentes zonas do menisco: sem modelagem para reparo do terço posterior (1), com a ponta modelada para reparo do terço médio (2), e com a haste modelada para tratamento de lesões no terço anterior (3).

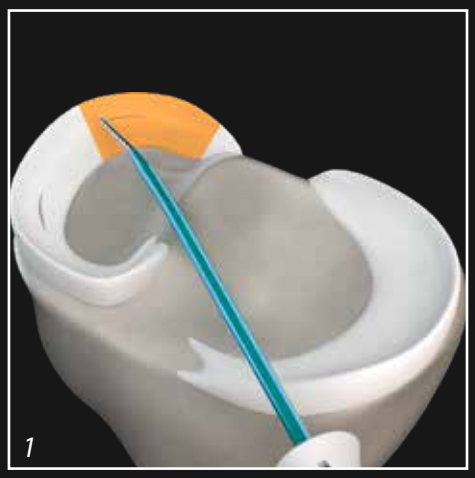

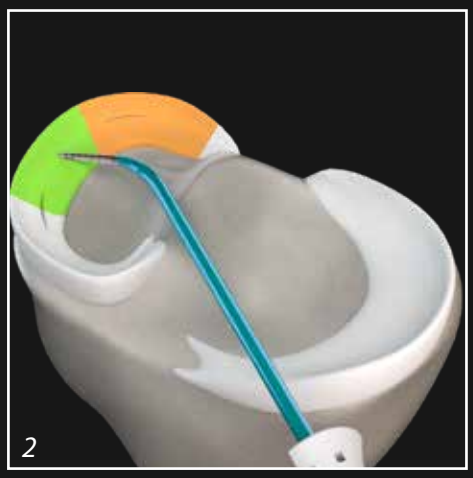

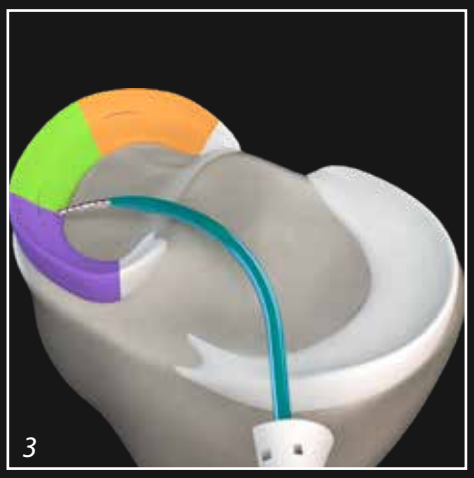

3. A técnica do reparo consiste na implantação de dois implantes em PEEK, um em cada lado da lesão, de dentro para fora do menisco de forma que se posicionem na borda externa. O fio de sutura #2 knotless fixado aos implantes realizará o reparo da lesão.

a. Deslocar o dispositivo de ajuste da profundidade da agulha para cobrir a ponta do insertor e introduzi-lo na articulação com segurança.

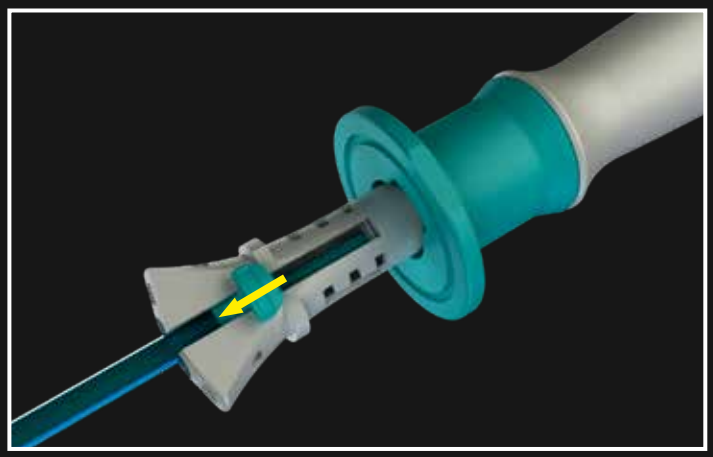

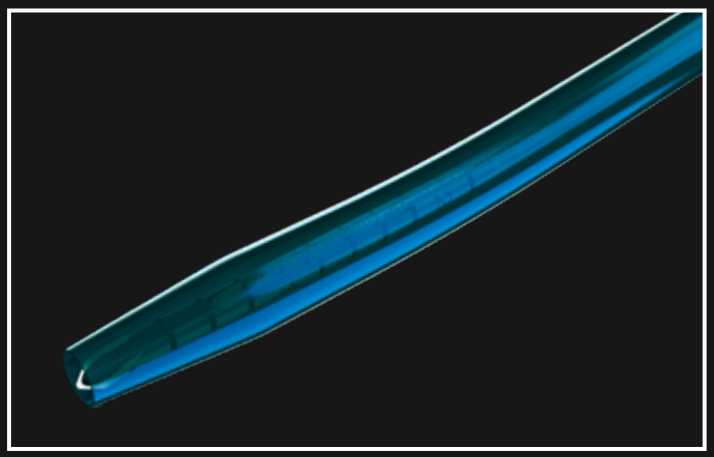

b. Após posicionar a ponta do insertor Meniscus Versaflex na região da lesão, retroceder o dispositivo de ajuste de profundidade para expor a agulha com o comprimento determinado pelo planejamento cirúrgico: 12 mm, 16mm ou 20 mm.

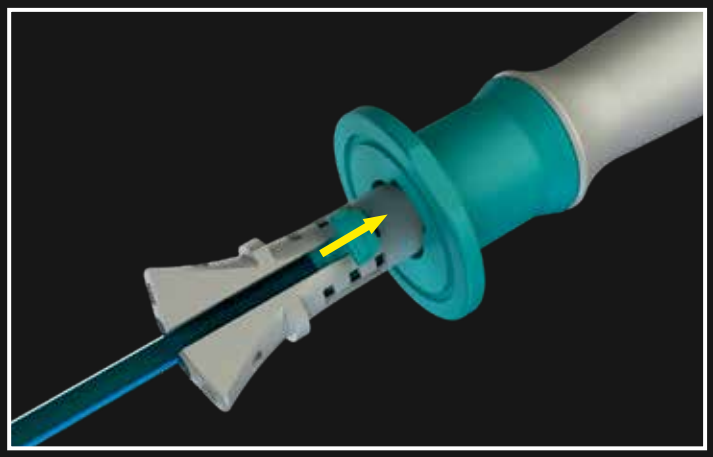

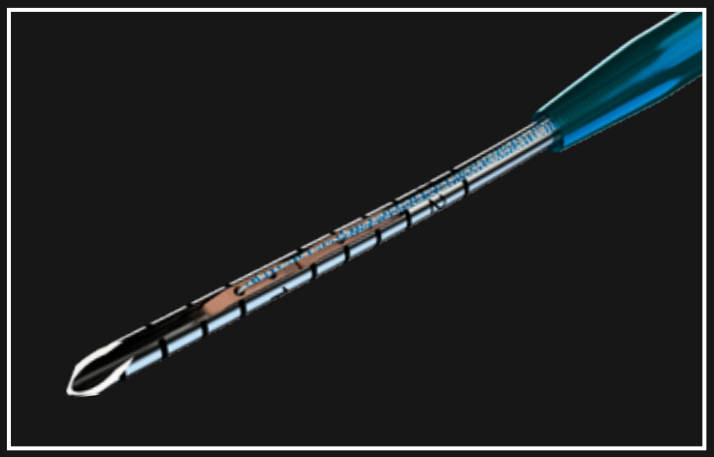

c. Introduzir a agulha do insertor em uma das bordas da lesão até que alcance a superfície externa do menisco.

d. Empurrar o dispositivo posicionador dos implantes Meniscus Versaflex até que se observe um "click" sonoro, que confirma a passagem do Implante Inicial do Meniscus Versaflex pelo menisco.

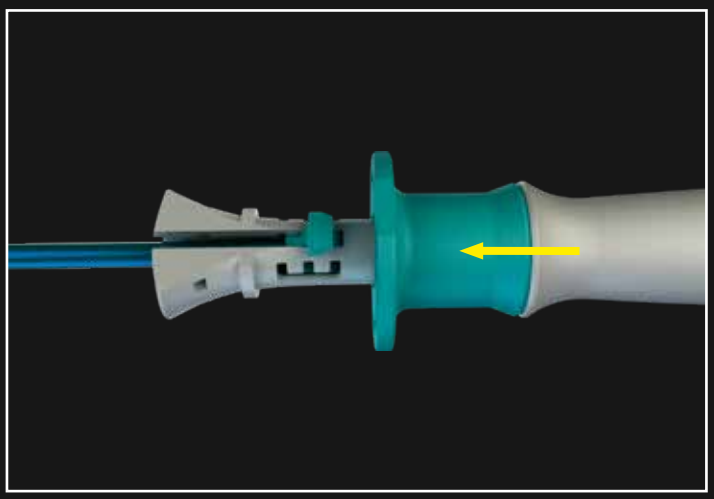

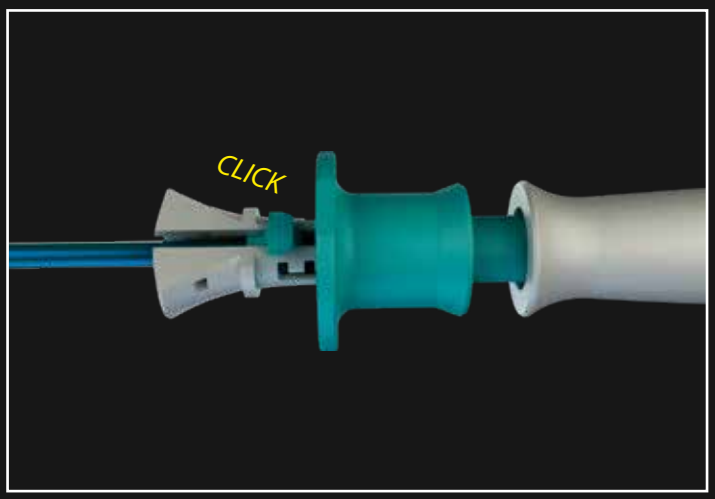

Fig.: Implante inicial em PEEK implantado na borda externa do menisco.

e. Retornar a agulha para a parte interna do menisco, e reintroduzir na outra borda da lesão, repetindo o movimento para passagem do Implante Secundário.

f. Remover a agulha pela parte interna do menisco, permanecendo os dois implantes na superfície externa, e tracionar o fio de sutura para ativar o sistema knotless e reparar a lesão.

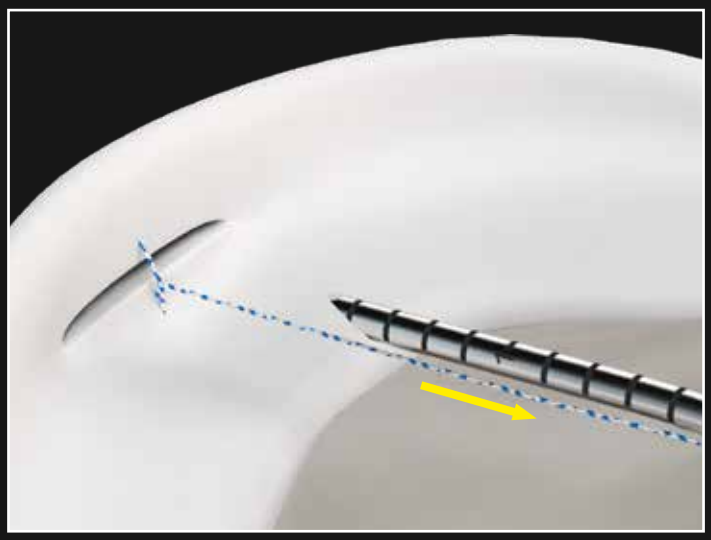

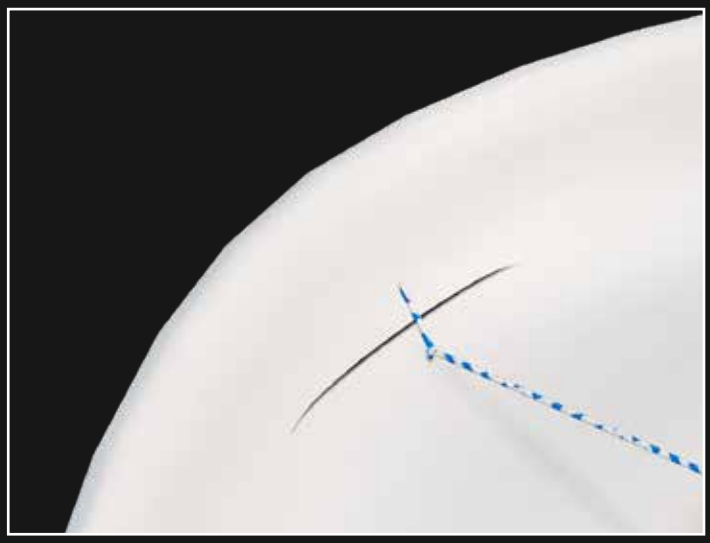

g. Checar o desempenho do reparo pela imagem da artroscopia e cortar o segmento residual da sutura.

MENISCUS VERSAFLEX

CÓDIGO

354-300

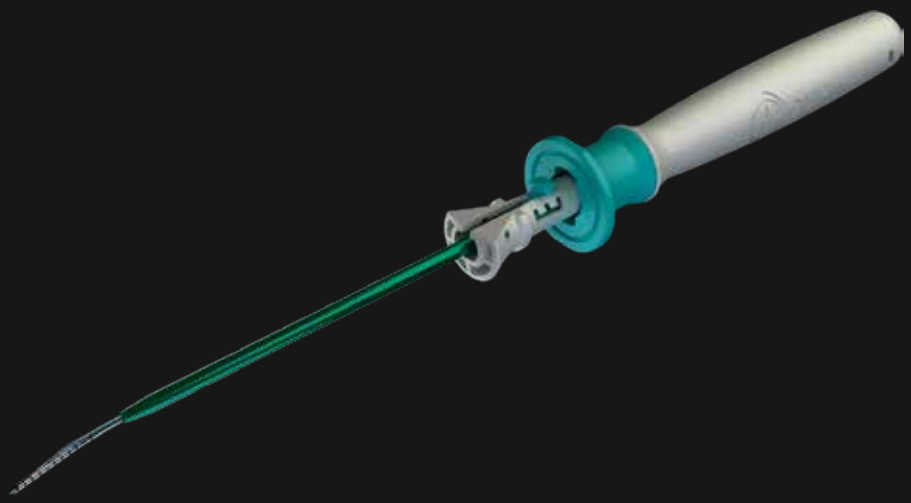

MENISCUS VERSAFLEX REVERSO

CÓDIGO

354-300

Nota

*O meniscus **Versaflex** e o **Versaflex Reverso** são apresentados em embalagem estéril de uso único, e acompanha o respectivo modelador descartável.*

MENISCUS VERSAFLEX | NOV / 2023 - REV. 00.

GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

MATRIZ I GMREIS
Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 I Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

GMReisBrasil **www.gmreis.com.br**

As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: **www.gmreis.com.br**.
GMReis. Todos os direitos reservados.

27November2023 11:44am