PRESSLOCK

ÂNCORAS EM PEEK SEM NÓ IMPACTADAS

PORTUGUÊS

GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2023

ÂNCORAS PRESSLOCK Ø2.5 X 8.0 MM

Âncoras em PEEK sem nó impactadas, com ilhós fechado, com diâmetro e comprimento adequados para o tratamento de lesões de tecidos moles das extremidades (e.g. pé, mão e punho).

Âncora indicada para uso com fio #2-0 Stitch GMReis.

Fig.: Reinserção da fibrocartilagem triangular com Presslock Ø2.5 x 8.0 mm e Sutura Stitch # 2-0.

Dispositivo de impactação da âncora com trava de segurança.

Âncora Presslock fornecida montada em cabo insertor.

Passa fio montado no ilhós da âncora.

PRESSLOCK – ÂNCORA EM PEEK SEM NÓ IMPACTADA DE ILHÓS FECHADO

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO
320-29155-SFPK-HIP	*2.5 mm*	*10.5 / 15.5 mm*

ÂNCORAS PRESSLOCK Ø2.9 X 15.5 MM

Âncoras em PEEK sem nó impactadas, com ilhós fechado, com diâmetro e comprimento adequados para o tratamento de lesões de tecidos moles em regiões como ombro e tornozelo.

Âcora indicada para uso com fio #2 Stitch GMReis.

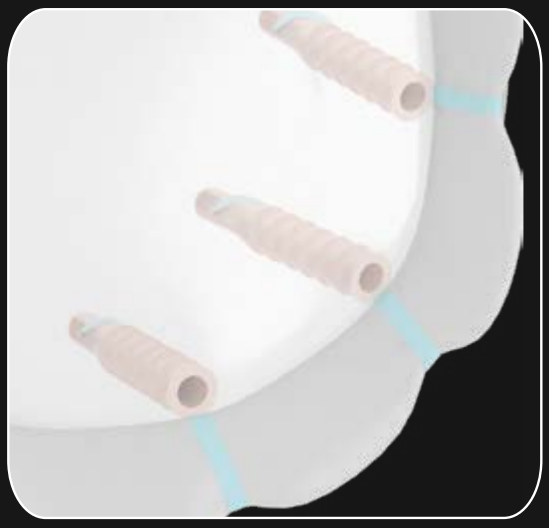

Fig.: Tratamento de lesão de Bankart com âncoras Presslock Ø2.9 x 15.5 mm e Suturas Stitch #2.

Dispositivo de impactação da âncora com trava de segurança.

Âncora Presslock fornecida montada em cabo insertor.

Passa fio montado no ilhós da âncora.

ÂNCORA EM PEEK SEM NÓ IMPACTADA PRESSLOCK DE ILHÓS FECHADO

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO
320-29155	*2.9 mm*	*15.5 mm*

ÂNCORAS PRESSLOCK HIP Ø2.9 X 15.5 MM

Âncoras em PEEK sem nó impactadas, com ilhós fechado, diâmetro e comprimento adequados ao tratamento da lesão labral do quadril, montadas em insertor e com instrumental longos desenvolvidos especialmente para procedimento artroscópico.

Fig.: Reparo de lesão labral do quadril com âncoras Presslock HIP Ø2.9 x 15.5 mm e Suturas Stitch #2.

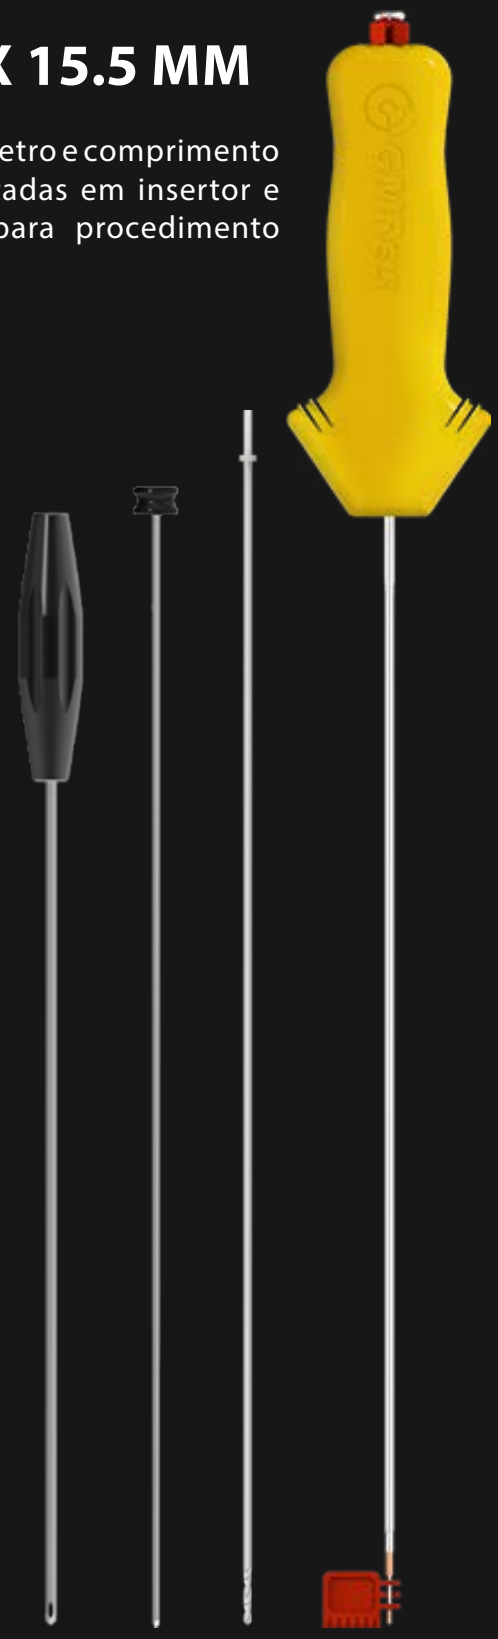

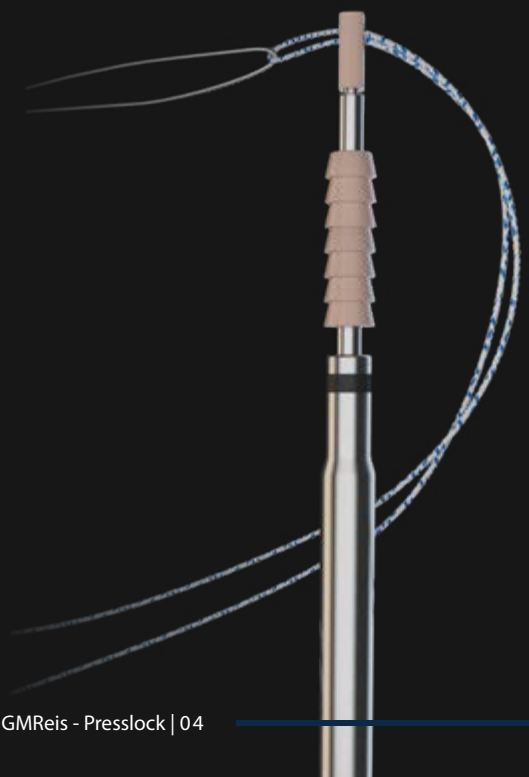

PRESSLOCK HIP – ÂNCORA EM PEEK SEM NÓ IMPACTADA DE ILHÓS FECHADO

CÓDIGO	Ø	COMPRIMENTO
320-29155-SFPK-HIP	*2.9 mm*	*10.5 / 15.5 mm*

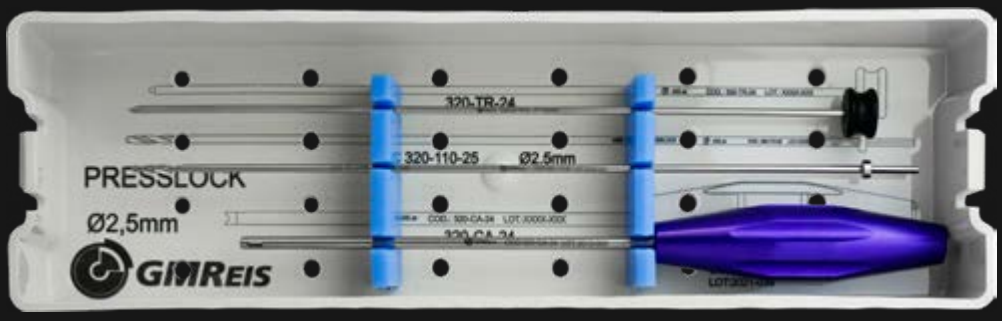

INSTRUMENTAL PRESSLOCK Ø2.5 x 8.0 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
320-CA-24	*Cânula Presslock Ø2.4 mm*
320-TR-24	*Ponta Trocar Presslock Ø2.4 mm*
320-110-25	*Broca Presslock Ø2.4 mm*

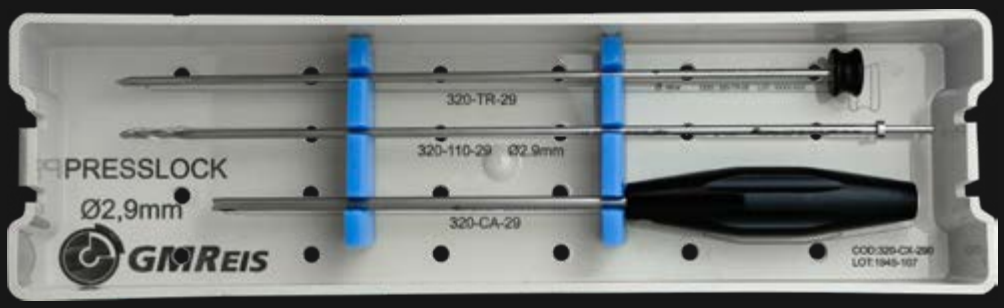

INSTRUMENTAL PRESSLOCK Ø2.9 x 15.5 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
320-CA-29	*Cânula Presslock Ø2.9 mm*
320-TR-29	*Ponta Trocar Presslock Ø2.9 mm*
320-110-29	*Broca Presslock Ø2.9 mm*

INSTRUMENTAL PRESSLOCK HIP Ø2.9 x 15.5 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
320-CA-29-HIP	*Cânula Presslock Ø2.9 mm HIP*
320-TR-29-HIP	*Ponta Trocar Presslock Ø2.9 mm HIP*
320-110-29-HIP	*Broca Presslock Ø2.9 mm HIP*

STITCH - FIOS E FITAS

As âncoras Presslock não acompanham fio ou fita; e para uso combinado são recomendados os Fios e Fitas Stitch.

Fig.: Todos os Fios e Fitas Stitch são fornecidos agulhados.

Fios de sutura e fitas de alta resistência não absorvíveis, fabricados com o polímero UHMWPE (polietileno de ulta alto peso molecular), biocompatíveis e com alta resistência contra: abrasão, quebra, alongamento, afrouxamento ou soltura de nós.

FIO DE UHMWPE COM AGULHA

CÓDIGO	MEDIDAS	COR	AGULHA
333-2-036-AB3817CI	*USP 2-0 – 45 cm*	*Azul e Branco*	*3/8 – 17 mm - Ponta Cilíndrica*
333-239-AB1226CI	*USP 2 – 90 cm*	*Azul e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*
333-239-PB1226CI	*USP 2 – 90 cm*	*Preto e Branco*	*1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica*

FITA DE UHMWPE COM AGULHA

CÓDIGO	MEDIDAS	COR	AGULHA
333-20-AB	*2.0 mm x 100 cm*	*Azul e Branco*	*1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica*
333-20-B	*2.0 mm x 100 cm*	*Preto e Branco*	*1/2 - 26 mm - Ponta Cilíndrica*

CATÁLOGO PRESSLOCK | JUL / 2023 - REV. 01.

GMREIS
Qualidade para Vida
Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

MATRIZ I GMREIS
Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 I Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

GMReisBrasil **www.gmreis.com.br**

As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis. Todos os direitos reservados.
© February 2024 11:31 am